

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА**  
**ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.“, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“*

Обособена позиция № 20 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 с предмет: Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 с предмет: Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 с предмет: Работен разтвор за флоуцитометри в литри;

Обособена позиция № 26 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 с предмет: Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 с предмет: Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;

Обособена позиция № 30 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции

ДО: Министерство на здравеопазването

От: "Диамед" ООД

с адрес: гр. София, ул. „Христо Ценов“ № 4,

тел.: 0892/27-35-79, 02/962 17 55, факс: 02/962 17 53, e-mail: giulfie\_imamova@diamed.bg,

office@diamed.bg

Булстат /ЕИК : 121062052,


Дата и място на регистрация по ДДС: 15.02.2002 г. в Национална агенция по приходите

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на

<http://www.diamed.bg>

e-mail: office@diamed.bg



предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.", включваща 48 самостоятелно обособени позиции"

Обособена позиция № 20 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 с предмет: Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 с предмет: Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 с предмет: Работен разтвор за флоуцитометри в литри;

Обособена позиция № 26 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 с предмет: Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 с предмет: Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;


Обособена позиция № 30 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции

Декларираме, че сме запознати с това че

1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 31.12.2015 г.
2. Срокът на изпълнение на всяка отделна доставка е първа доставка до 7 календарни дни от сключване на договора и получаване на писмена заявка – разпределение. Следващи доставки - до 14 /четирнадесет/ календарни дни след писмена заявка от Дирекция „ОЗ“, Министерство на здравеопазването.
3. Нашето предложение е както следва /характеристика на предлаганото изделие и каталожен номер за проверка на съответствието/:

№	НАИМЕНОВАНИЕ по спецификация	Мярка	Количества до ...	Предложение на участника
	Диагностикуми за имунологичен мониторинг на пациенти с ХИВ/СПИН за нуждите на Националната имунологична лаборатория			
	Тестове за количествено определяне на CD4 и CD8 T лимфоцити			
20	Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45	Брой тестове	2 800	BD™ Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 with Trucount Tubes, 50 теста, кат.номер 302447






21	Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45	Брой тестове	550	BD™ Tritest CD3/CD4/CD45 with Trucount Tubes, 50 теста, кат.номер 342444
22	Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45	Брой тестове	550	BD™ Tritest CD3/CD8/CD45 with Trucount Tubes, 50 теста, кат.номер 342441
	Консумативи за работа с китовите по поз. от 18 до 20			
23	Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в мл	Милилитри	1 000	BD FACSTM Lysing Solution, 100 мл, кат.номер 349202
24	Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 mm	Брой	9 000	Falcon™ Round-Bottom Tubes 12x75 mm, 5 ml with cap, 1000 бр/оп, кат.номер 352054
25	Работен разтвор за флоуцитометри в л	Литри	560	BD FACSTFlow™ Sheath Fluid, 20 л, кат.номер 342003
26	Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в л	Литри	50	BD FACSTM Clean, 5 л, кат.номер 340345
27	Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в л	Литри	10	BD FACSTM Rinse, 5 л, кат.номер 340346
28	Разтвор за спиране на флоуцитометър в л	Литри	90	BD FACSTM Shutdown Solution, 5 л, кат.номер 334224
	<b>Стандарти и китове за калибриране</b>			
29	Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки	Брой тестове	30	BD™ Trucount Controls, 30 бр, кат.номер 340335
30	Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции	Брой тестове	175	BD FACSTM 7-color Setup Beads, 25 теста, кат.номер 335775
31	Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции	Брой тестове	150	BD™ Calibrite 3 Beads (unlabeled, FITC, PE, PerCP), 25 теста, кат.номер 340486

1. Декларираме, че всяка партида на диагностиките, които ще доставяме ще притежават сертификат за качество от производителя.
2. Декларираме, всеки диагностикуми, който ще доставим, ще бъде придружен с документ, в който е обявен производствения срок на годност.
3. Декларираме, че срокът на годност на медицинските изделия за диагностика, ще бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя.



4. Декларираме, че тестовете за първична диагностика на СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис ще бъдат в съотношение 30 % големи към 70 % малки опаковки.
5. Декларираме, че предлаганите от нас диагностикуми са последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на оферирание.
6. Декларираме, че тестовете за ТПХА по позиция №14 ще бъдат окомплектовани със съответния брой плаки и връхчета.
7. Декларираме, че за всички тестове за диагностика ELISA, ще бъдат окомплектовани със съответния брой връхчета, съобразно броя на тестовете.
8. Декларираме, че ако за изработване на някои тестове няма налична апаратура, ще предоставим и ще поддържаме такава за времето, в което ще се изработват доставяните от нас тестове.
9. Декларираме, че ще поддържаме за своя сметка наличната извънгаранционна апаратура на която ще се изработват неговите тестове;
10. Декларираме, че предоставената за наша сметка апаратура, на която ще се работи с доставяните от нас тестове ще е с технически параметри не по-ниски от тези на съществуващата.
11. Декларираме, че в случай, че тестовете за вирусен товар, които ще доставяме се изисква екстракция на вирусна РНК, ще предоставим апарат за автоматична екстракция на РНК.
12. Декларираме, че ще осигурим програмирането на наличната апаратура за изработването и синхронизирането на доставяните от нас тестове.
13. Декларираме, че ще осигурим обучение на персонала за работа с доставяните от нас тестове.
14. Декларираме, че ~~тестовете по позиция 37 ще са с чувствителност равна или по-висока от 99%, специфичност равна или по-висока от 96%. Тестовете за потвърдителна диагностика на ХИВ1/2 инфекция ще се изпълняват върху стрипове натоварени с рекомбинантни ХИВ 1/2 антигени. Реагентите в кита да ще са готови за употреба без предварително разреждане. Процедурата за изпълнение ще е автоматизирана. Резултатите ще се отчитат чрез сканиране и компютърна програма и ще се документират на хартиен носител.~~
15. Декларираме, че предлагания от нас тест по позиция 2 е бърз качествен тест за откриване на антитела срещу вируса причиняващ имунен дефицит у човека, типове 1 и 2. С чувствителност равна или по-висока от 99 %. Специфичност равна или по-висока от 98%. Възможност да открива специфични анти-ХИВ антитела в проби от периферна кръв. Процедурата за изпълнение да не изисква специално лабораторно оборудване за изпълнение на теста (автоматични пипети, инкубатор, шейкър и др.). Тестовете ще бъдат комплектовани с автоматични ланцети за вземане на проби от периферна кръв. Всички реактиви за изработване на проби от цяла кръв, плазма и серум да бъдат включени в диагностичния тест кит. Процедурата за изпълнение на теста да не надвишава 5 минути. Времето за отчитане на резултата да не надвишава 20 минути от приключване на процедурата по изработване на теста.
16. Декларираме, че тестовете за определяне на вирусен товар на HIV по позиция 34 ще се изпълняват напълно автоматично и ще са с долна граница на детекция до 50 вирусни копия /на милилитър.
17. Декларираме, че ~~тестовете по позиция 42 и 43; 45 и 46; 47 и 48 са на принципа на капиллярна гел електрофореза секвениране при минимално едновременно зареждане от 6 проби за изследване.~~
18. Декларираме, че тестовете за диагностика на хепатит В ще са с чувствителност равна на или под 0,130 IU/ml. повърхностен антиген на хепатит В с специфичност не по-малка от 99%.

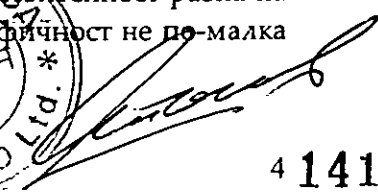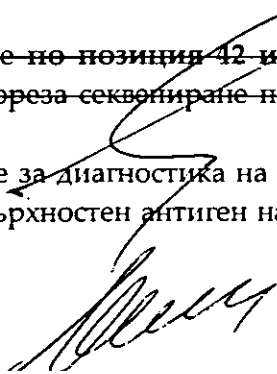

~~19. Декларираме, че тестовете за първична диагностика на СПИН – ЕЛИЗА по позиция 1 ще бъдат тип антиген – антитяло. Чувствителността на теста за антителата да е 100%, специфичността да не е по-ниска от 99%. Чувствителността за детекция на ХИВ антигена да е под 2 IU/ml.~~

Приложение:

Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител – Приложени в Плик № 1 „Документи за подбор“.


\*Забележка:

Предложенията за изпълнение на поръчката по обособени позиции, които съгласно настоящата документация се предлагат и доставят комплексно, се представят в общ Плик № 2.

Дата: 11.05.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

(подпис печат)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Свет".

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "М".

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА**  
**ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

*„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.“, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“*

Обособена позиция № 20 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 с предмет: Лизирац и фиксирац разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 с предмет: Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 с предмет: Работен разтвор за флоуцитометри в литри;

Обособена позиция № 26 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 с предмет: Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 с предмет: Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;

Обособена позиция № 30 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции

ДО: Министерство на здравеопазването

От: "Диамед" ООД

с адрес: гр. София, ул. "Христо Ценов" № 4,

тел.: 0892/27-35-79, 02/962 17 55, факс: 02/962 17 53, e-mail: giulfie\_imamova@diamed.bg, office@diamed.bg

регистриран по ф.д. № 3648 / 1996 г. по описа на Софийски градски съд,

ЕИК / Булстат: 121062052,

Дата и място на регистрация по ДДС: 15.02.2002 г. в Национална агенция за приходите

Разплащателна сметка:

банков код: UNCRBGSF


банкова сметка: BG51UNCR76301006701503

банка: Уникредит Булбанк АД

град/клон/офис: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 7 - Централна

<http://www.diamed.bg>

e-mail: office@diamed.bg

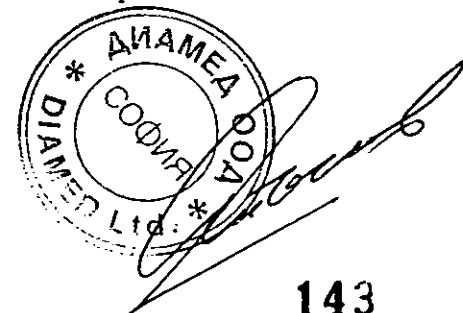

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.“, включваща 48 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № 20 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 21 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45;

Обособена позиция № 22 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45;

Обособена позиция № 23 с предмет: Лизирац и фиксирац разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри;

Обособена позиция № 24 с предмет: Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра;

Обособена позиция № 25 с предмет: Работен разтвор за флоуцитометри в литри;

Обособена позиция № 26 с предмет: Почиствац разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри;

Обособена позиция № 27 с предмет: Почиствац разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри;

Обособена позиция № 28 с предмет: Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри;

Обособена позиция № 29 с предмет: Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки;

Обособена позиция № 30 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции;

Обособена позиция № 31 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единична цена по обособена позиция № 20 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ и CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD8/CD3/CD45 в размер:

27.8956 лв. (словом: двадесет и седем цяло осем хиляди деветстотин петдесет и шест десетохилядни лв.) без ДДС

и 33.4747 лв. (словом: тридесет и три цяло четири хиляди седемстотин четиридесет и седем десетохилядни лв.) с начислен ДДС.


Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

78 107.68 лв. (словом: седемдесет и осем хиляди сто и седем лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС

и 93 729.16 лв. (словом: деветдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестнадесет стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 21 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD4+CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD4/CD3/CD45 в размер:

19.0540 лв. (словом: деветнадесет цяло петстотин и четиридесет десетохилядни лв.) без ДДС



и 22.8648 лв. (словом: двадесет и две цяло осем хиляди шестстотин четиридесет и осем десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

√ 10 479.70 лв. (словом: десет хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) без ДДС

и 12 575.64 лв. (словом: дванадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 22 с предмет: Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на абсолютния брой на CD8 +CD3+ лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD8/CD3/CD45 в размер:

19.0540 лв. (словом: деветнадесет цяло петстотин и четиридесет десетохилядни лв.) без ДДС

и 22.8648 лв. (словом: двадесет и две цяло осем хиляди шестстотин четиридесет и осем десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

√ 10 479.70 лв. (словом: десет хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) без ДДС

и 12 575.64 лв. (словом: дванадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 23 с предмет: Лизиращ и фиксиращ разтвор за проби от цяла кръв без промиване в милилитри в размер:

3.9753 лв. (словом: три цяло девет хиляди седемстотин петдесет и три десетохилядни лв.) без ДДС

и 4.7704 лв. (словом: четири цяло седем хиляди седемстотин и четири десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

√ 3 975.30 лв. (словом: три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и тридесет стотинки) без ДДС

и 4 770.40 лв. (словом: четири хиляди седемстотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 24 с предмет: Епруветки за флоуцитометър 12 x 75 в милиметра в размер:

0.1967 лв. (словом: нула цяло хиляда деветстотин шестдесет и седем десетохилядни лв.) без ДДС

и 0.2360 лв. (словом: нула цяло две хиляди триста и шестдесет десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

√ 1 770.30 лв. (словом: хиляда седемстотин и седемдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС

и 2 124.00 лв. (словом: две хиляди сто двадесет и четири лева) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 25 с предмет: Работен разтвор за флоуцитометри в литри в размер:


3.5125 лв. (словом: три цяло пет хиляди сто двадесет и пет десетохилядни лв.) без ДДС

и 4.2150 лв. (словом: четири цяло две хиляди сто и петдесет десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

√ 1 967.00 лв. (словом: хиляда деветстотин шестдесет и седем лева) без ДДС

и 2 360.40 лв. (словом: две хиляди триста и шестдесет лева и четиридесет стотинки) с начислен ДДС.

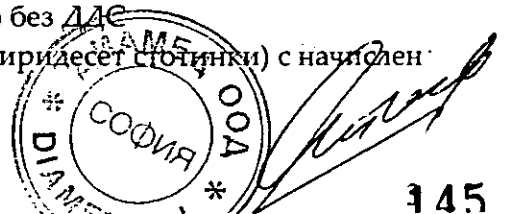



Единична цена по обособена позиция № 26 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ натриев хипохлорит и натриева основа в литри в размер: 14.0500 лв. (словом: четиринадесет цяло и петстотин десетохилядни лв.) без ДДС и 16.8600 лв. (словом: шестнадесет цяло осем хиляди и шестстотин десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:  
√ 702.50 лв. (словом: седемстотин и два лева и петдесет стотинки) без ДДС  
и 843.00 лв. (словом: осемстотин четиридесет и три лева) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 27 с предмет: Почистващ разтвор за флоуцитометър, съдържащ калиев хлорид, дибазичен калиев фосфат и натриев азид в литри в размер:

14.0500 лв. (словом: четиринадесет цяло и петстотин десетохилядни лв.) без ДДС  
и 16.8600 лв. (словом: шестнадесет цяло осем хиляди и шестстотин десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:  
√ 140.50 лв. (словом: сто и четиридесет лева и петдесет стотинки) без ДДС  
и 168.60 лв. (словом: сто шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 28 с предмет: Разтвор за спиране на флоуцитометър в литри в размер:

14.0500 лв. (словом: четиринадесет цяло и петстотин десетохилядни лв.) без ДДС  
и 16.8600 лв. (словом: шестнадесет цяло осем хиляди и шестстотин десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:  
√ 1 264.50 лв. (словом: хиляда двеста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС  
и 1 517.40 лв. (словом: хиляда петстотин и седемнадесет лева и четиридесет стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 29 с предмет: Стандарт за качествен контрол на измерването на нисък, среден и висок абсолютен брой клетки в размер:

13.2510 лв. (словом: тринадесет цяло две хиляди петстотин и десет десетохилядни лв.) без ДДС  
и 15.9012 лв. (словом: петнадесет цяло девет хиляди и дванадесет десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:  
√ 397.53 лв. (словом: триста деветдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) без ДДС  
и 477.04 лв. (словом: четиристотин седемдесет и седем лева и четири стотинки) с начислен ДДС.

Единична цена по обособена позиция № 30 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 7 флуоресценции в размер:

31.9500 лв. (словом: тридесет и едно цяло девет хиляди и петстотин десетохилядни лв.) без ДДС  
и 38.3400 лв. (словом: тридесет и осем цяло три хиляди и четиристотин десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:  
√ 5 591.25 лв. (словом: пет хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС.  
и 6 709.50 лв. (словом: шест хиляди седемстотин и девет лева и петдесет стотинки) с начислен ДДС.



Единична цена по обособена позиция № 31 с предмет: Калибратор за автоматично калибриране на флоуцитометър - 3 флуоресценции в размер:

15.5584 лв. (словом: петнадесет цяло пет хиляди петстотин осемдесет и четири десетохилядни лв.) без ДДС

и 18.6701 лв. (словом: осемнадесет цяло шест хиляди седемстотин и една десетохилядни лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

✓ 2 333.76 лв. (словом: две хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС

и 2 800.52 лв. (словом: две хиляди и осемстотин лева и петдесет и две стотинки) с начислен ДДС.

Общата комплексна цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособени позиции № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30 и № 31, е:

117 209.72 лв. (словом: сто и седемнадесет хиляди двеста и девет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС

и 140 651.30 лв. (словом: сто и четиридесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет стотинки) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Всички оферирани цени, следва да бъдат закръглени до четвъртия знак десетичната запетая.


При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична / банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: 11.05.2015 г.

д-р Марио Танев: \_\_\_\_\_  
(подпис, печат)

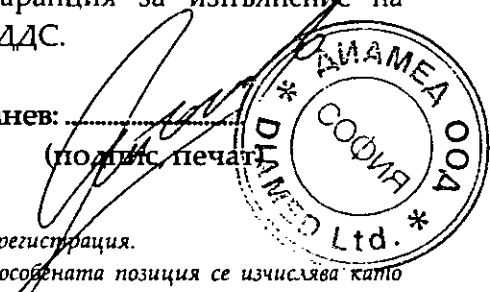

Забележка 1: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Забележка 2: Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция се изчислява както произведение на единичната цена и количеството.

Забележка 3: За позициите, които се оферират комплексно се представя общо ценово предложение и се отбелязват както единичните и общите цени за всяка отделна позиция без и със ДДС, така и обща комплексна стойност без и със ДДС, представляваща сбор от съответните общи стойности на отделните позиции, които се доставят комплексно.

\*Забележка: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.